

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI**  
**BROJ OP-27/18**  
**(Centrifuge)**

Zaključen između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj 4200174570004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr. Fuad Husić ( u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

2. **Diamedic d.o.o.**, sa sjedištem u Sarajevu ,ulica Nike Kolumbića Šake br.22, ID 4200072730007, koju zastupa direktor Dubravko Barbarić, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

**I Osnova za zaključenje ugovora**

**Član 1.**

Osnov za zaključenje ugovora je Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 01-03-4500/18 od 18.05.2018 godine, u postupku javne nabavke broj OP 27/18 .

Ovim ugovorom ugovorne strane utvrđuju vrstu i količinu robe koju će izvršilac isporučiti naručiocu, međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

**II Predmet ugovora**

**Član 2.**

Predmet ugovora je nabavka i isporuka **Centrifuga - 4 komada**, za potrebe Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, bliže specificirana u ponudi Izvršioca, koja je sastavni dio Ugovora.

Predmet ugovora koji se isporučuje mora biti bez ikakvih oštećenja, proizvodnih nedostataka i da zajedno sa pratećom dokumentacijom kao cjelinom, ispunjava postavljene tehničke zahtjeve.

**III Ukupna vrijednost ugovora**

**Član 3.**

Ukupna vrijednost ugovora iz člana 2. Ugovora, sa uključenim PDV-om iznosi:

**27.986,40 KM**

(Slovima:Dvadesetsedamhiljadadevetstinaosamdesetšest KM i 40/100 pf).

#### **IV Obezbjedenje sredstava**

##### **Član 4.**

Sredstva u iznosu iz člana 3. Ugovora, obezbjedit će Naručilac iz namjenskih sredstava Ministarstva zdravstva KS.

#### **V Cijena**

##### **Član 5.**

Za isporučenu robu važe cijene iz tenderske ponude koje se ne mogu mijenjati, a sastavni su dio ovog ugovora.

#### **VI Stupanje na snagu ugovora**

##### **Član 6.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca i traje do isporuke, instalacije i puštanja u rad predmeta nabavke u skladu sa Aneksom 2 tenderske dokumentacije.

#### **VII Rok i način isporuke**

##### **Član 7.**

Rok isporuke predmeta Ugovora je najduže u roku do 30 dana od dana prijema narudžbenice.

Izvršilac je dužan da 3 (tri) dana prije predviđene i planirane isporuke predmeta ugovora, o tome obavijesti ovlaštenog predstavnika Naručioca (šef Tehničke službe), koji određuje dinamiku i mjesto isporuke predmeta Ugovora.

Prilikom isporuke predmeta ugovora Izvršilac je obavezan predati ovjerenu i potpisanu izjavu da predmet ugovora nema nikakvih nedostataka i da je u svemu u skladu sa prihvaćenom ponudom.

##### **Član 8.**

Predmetna roba mora biti osigurana od mjesta utovara do mjesta odredišta od nastupanja eventualne štete u transportu za koju odgovornost snosi Izvršilac.

Ako se zapisnički utvrdi da roba koju je Izvršilac dostavio ima nedostatke u kvalitetu i očiglednih grešaka - vidljivi nedostaci, Naručilac odmah, bez odlaganja obavještava Izvršioca da iste otkloni ili zamijeni robom ugovorenih karakteristika u skladu sa tehničkim zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

##### **Član 9.**

Smatra se da je izvršena adekvatna isporuka kada se u mjestu isporuke izvrši kvantitativan i količinski prijem robe, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju najmanje dva odgovorna lica koje odredi direktor orgnizacione jedinice na licu mjesta i najmanje jedno ovlašćeno lice Izvršioca.

Zapisnik iz predhodnog stava i dostavljena faktura Naručiocu, predstavljaju osnov za plaćanje ugovorne cijene.

## **VIII Garantni rok i garancija za dobro izvršenje**

### **Član 10.**

Izvršilac je odgovoran za ispravnost predmeta Ugovora u garantnom roku.

Izvršilac odobrava garanciju na aparate u trajanju od 24 mjeseca, sa svim garantnim pravima.

Garancija počinje teći danom stavljanja predmeta Ugovora u funkciju, do kada je Izvršilac obavezan, uz isporučeni predmet Ugovora dostaviti i uredno ovjeren garantni list.

### **Član 11.**

U slučaju kvara aparata u garantnom roku, Izvršilac je dužan da obezbjedi dolazak ovlaštenog servisera na lice mjesta, u roku koji ne može biti duži od 48 sati, računajući od dana prijema poziva.

Svi troškovi popravke predmeta Ugovora u garantnom roku padaju na teret Izvršioca.

Za svaki dan nefunkcionisanja predmeta Ugovora u garantnom roku, garancija se produžava.

Ukoliko Izvršilac, u vrijeme trajanja garantnog roka, ne vrati predmet Ugovora u funkcionalno stanje u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana prijave kvara, dužan je da izvrši zamjenu rashladnog uređaja sa novim, o svom trošku, koji mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika od ugovorenih.

### **Član 12.**

Izvršilac je obavezan da Naručiocu, najkasnije prilikom potpisivanja ugovora, na ime obezbjeđenja urednog izvršenja obaveza, preda bankovnu garanciju u visini od 3% ugovorene vrijednosti robe, koja je neopoziva, безусловna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv. Garancija mora da važi do okončanja ugovorenog roka isporuke.

Naručilac je obavezan izvršiti povrat garancije po izvršenoj isporuci robe.

Forma bankovne garancije određena je članom 6. Pravilnika o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

Pokriće iz bankarske garancije ne oslobađa Izvršioca ugovora odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

## **IX Način i uslovi plaćanja**

### **Član 13.**

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku do 30 dana od dana ispostavljenе fakture.

**X Ostale odredbe**

**Član 14.**

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti nalažen Sud u Sarajevu.

**Član 15.**

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 16.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Izvršioca, a sačinjen je u pet primjeraka od kojih Naručilac zadržava četiri primjerka (SEFP, Koordinator za Laboratoriju, STP, JN) a Izvršilac, jedan primjerak.

**NARUČILAC**

Javna ustanova Dom zdravlja  
Kantona Sarajevo

Generalni direktor

Mr.med.sci.prim.dr Fuad Husić  
Spec.porođične/obiteljske medicine



Dana, 17.07.2018 godine  
Broj: 01-03-4500-7/18

**IZVRŠILAC**

Diamedic d.o.o

Direktor

Dubravko Barbarić



Dana, 24.07.2018.  
Broj: 1746-4/2018

## OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: DIAMEDIC D.O.O.Adresa ponuđača: NIKE KOLUMBIĆA ŠAKA 22, SARAJEVOKontakt telefon: 033 776 291Kontakt osoba: ADNAN MIROJEVIĆ

Predmet nabavke

Centrifuge Evidencijski broj: OP 27/18

Opis robe	Proizvođač	Model aparata	Jed. mjere	Količ.	Jedinična cijena bez PDV-a u KM	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM
Centrifuge	HERMLE LABORTECHNIK	Z 306	kom	4	5.980,00	23.920,00
POPUST %						0,00
Vrijednost bez PDV-a sa uračunatim popustom						23.920,00
PDV 17 %						4.066,40
UKUPNA VRIJEDNOST SA PDV-om u KM						27.986,40
ima ukupno sa PDV-om: <u>DVADESET SEDAM TISUĆA DESET STOTINA OSMO DESET PET KM I 40/100</u>						

Rok plaćanja 30 dana od dana ispostavljanja fakture


Rok isporuke: 30 dana od dana prijema narudžbenice

Garantni rok na aparate: 24 MJESECA OD DATUMA INSTALACIJE.

Mjesto isporuke: JU Dom zdravlja KS

Sastavni dio obrasca sa cijenu ponude je obrazac Tehničke specifikacije Aneks 2a

Potpis i pečat ponuđača

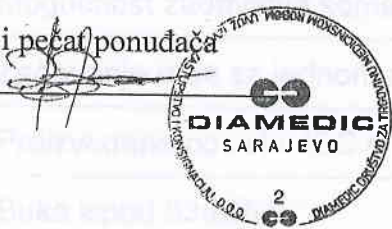


SARAJEVO, 07.06.2018.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

PREDMET NABAVKE: Centrifuge (4 komada)  
Evidencijski broj OP 27/18

	Tražene tehničke karakteristike	DA	NE
1.	Maksimalna brzina centrifuge ne manja od: 14 000 rpm	DA	
2.	Max RCF ne manji od: 18 000xg	DA	
3.	Maksimalni ukupni volume ne manji od : 4x100 ml	DA	
4.	Podešavanje brzine u koracima po 10 za rpm I rcf	DA	
5.	Rotor: swing-out rotor sa 4 kivete	DA	
6.	Adapteri za epruvete ukupno 28 mjesta 15 ml, Ø17 mm, min 90/max 110 mm	DA	
7.	Swing out rotor ugao 90°, da može raditi na brzinama ne manjim od 4500 rpm I 3300 rcf	DA	
8.	Dai ma automatsko prepoznavanje rotora	DA	
9.	Dai ma automatsko isključivanje kod disbalansa	DA	
10.	Da ima sistem za toletisanje određenog nivoa imbalansa	DA	
11.	Da ima zaštitu od prekoračenja brzine za postavljeni rotor	DA	
12.	Da ima 10 nivoa ubrzanja I kočenja	DA	
13.	Izbor vremena rada: od 10 sekunda do minimum 99 sati	DA	
14.	Mikroprocesorsko upravljanje	DA	
15.	LCD displej sa prikazom zadanih I aktuelnih vrijednosti	DA	
16.	Automatsko zaključavanje poklopca	DA	
17.	Ventilacijski sitem koji održava uzorke hladnim	DA	
18.	Mogućnost zadavanja komandi u rukavicama	DA	
19.	Zadavanje rada sa jednom rukom	DA	
20.	Proizvedene pos vim IEC 61010 standardima	DA	
21.	Buka ispod 63dBA	DA	

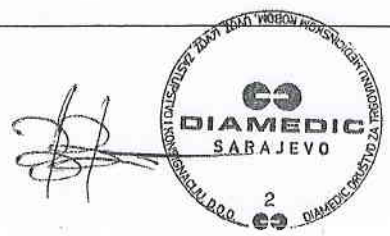

22.	Dijagnostički program-prikaz grešaka	DA	
23.	Memorija za najmanje 90 programa rada sa uključenim prepoznavanjem rotora	DA	
24.	Zvučni signal za kraj rada	DA	
25.	Garantni rok min 24 mjeseca	DA	

SARAJEVO, 07.06.2018.



[www.judzks.ba](http://www.judzks.ba)